



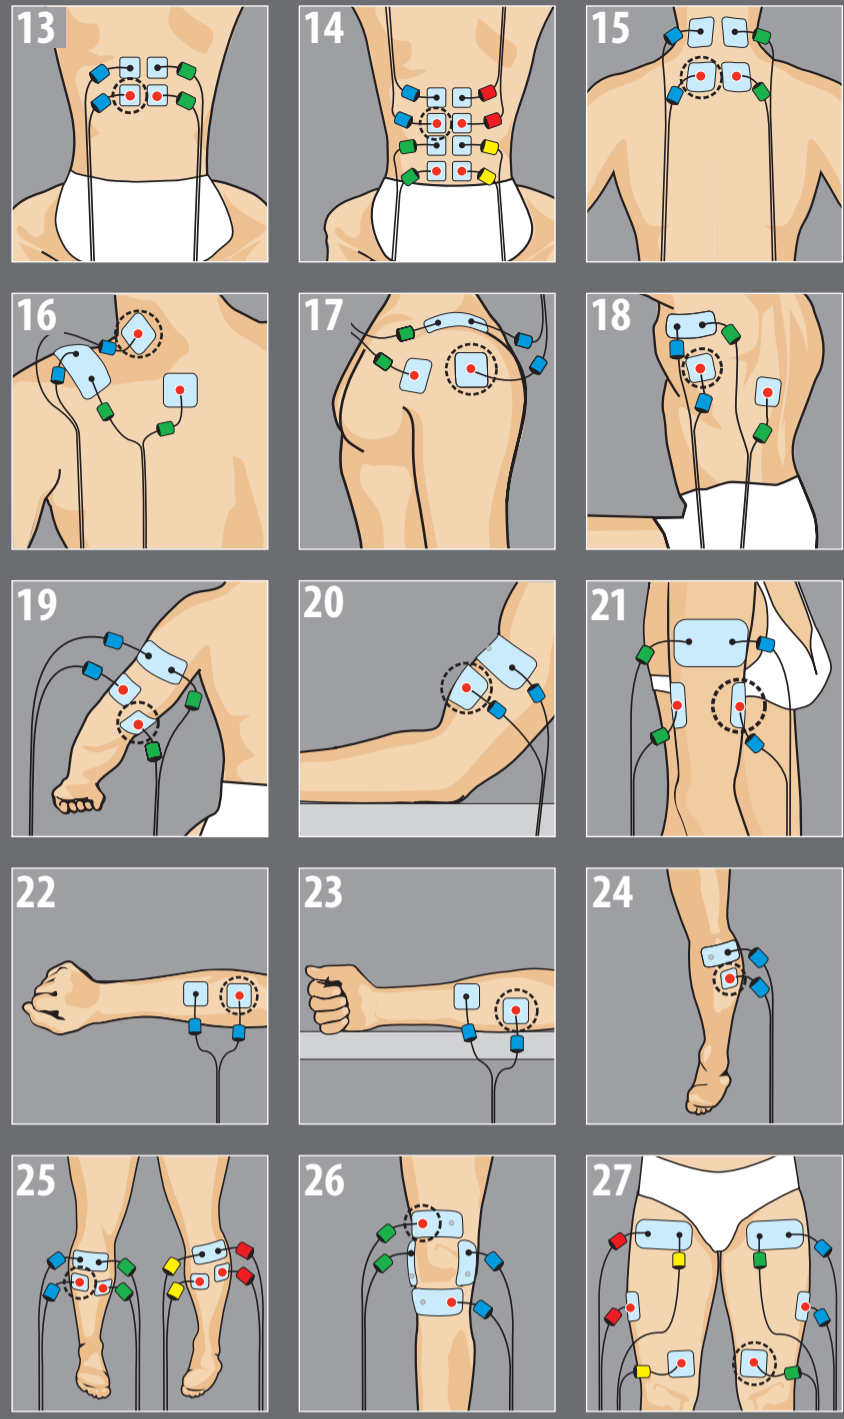


Compex®

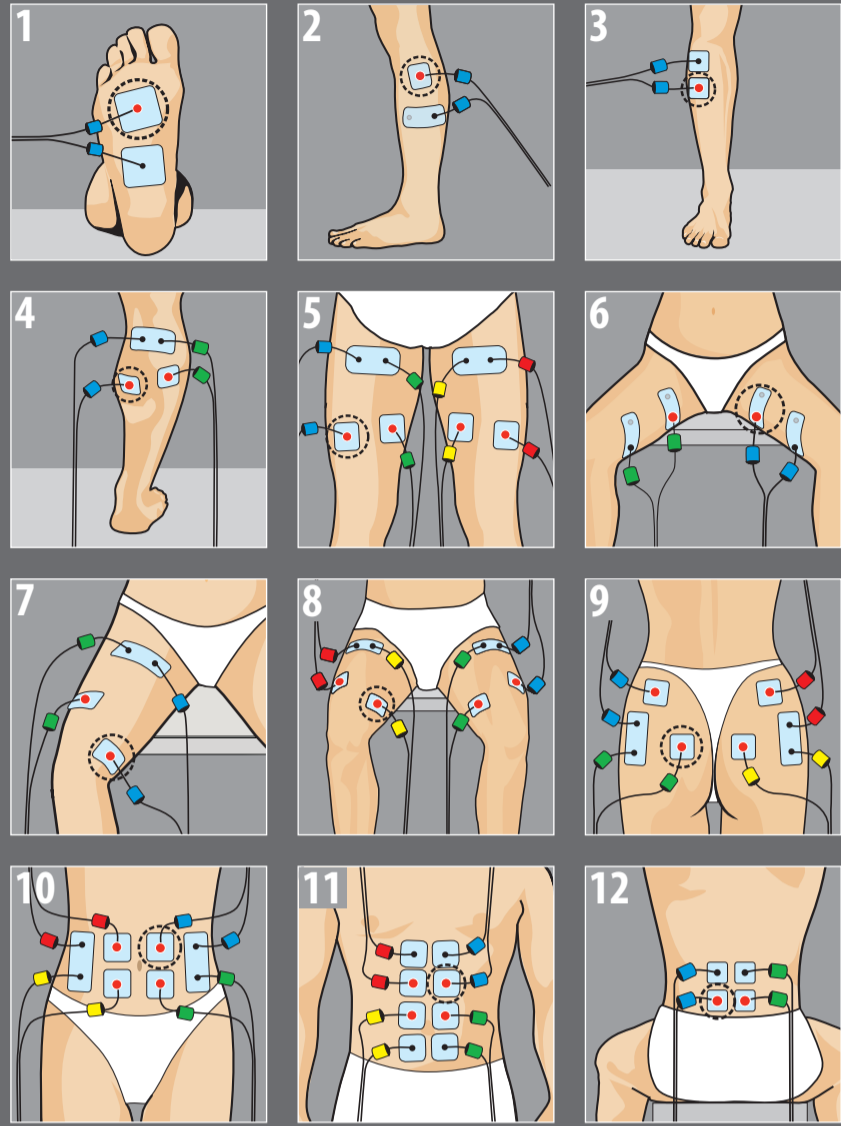

⚠ Les normes internationales en vigueur imposent une mise en garde relative à l'application des électrodes au niveau du thorax (risque de fibrillation cardiaque accru).

Current international standards require that a warning be given concerning the application of electrodes to the thorax (increased risk of cardiac fibrillation).

De geldende internationale normen eisen dat wordt gewaarschuwd tegen het aanbrengen van de elektroden ter hoogte van de borstkas (verhoogd gevaar voor hartfibrillatie).

Die geltenden internationalen Normen verlangen einen Warnhinweis in Bezug auf die Platzierung der Elektroden im Bereich des Thorax (erhöhtes Risiko für die Auslösung von Herzflimmern).

Las normas internacionales vigentes exigen una advertencia referente a la aplicación de los electrodos en el tórax (se incrementa el riesgo de fibrilación cardíaca).

Le norme internazionali in vigore impongono la segnalazione relativa all'applicazione degli elettrodi a livello del torace (aumento del rischio di fibrillazione cardiaca).

⦿ Emplacement du *Mi-SENSOR* seulement disponible avec les appareils dotés de la technologie muscle intelligence™.

Mi-SENSOR location only for stimulators with muscle intelligence™ technology.

Aanduiding van de *Mi-SENSOR* alleen verkrijgbaar bij de apparaten met de muscle intelligence™ technologie.

Die Platzierung des *Mi-SENSOR* ist nur bei Geräten verfügbar, die mit der muscle intelligence™ Technologie ausgestattet wurden.

La posición de *Mi-SENSOR* solo es válida para aquellos aparatos con tecnología muscle intelligence™.

L'applicazione del *Mi-SENSOR* è disponibile solamente con gli apparecchi dotati di tecnologia muscle intelligence™.

www.complex.info

www.complex.info

Compex®